

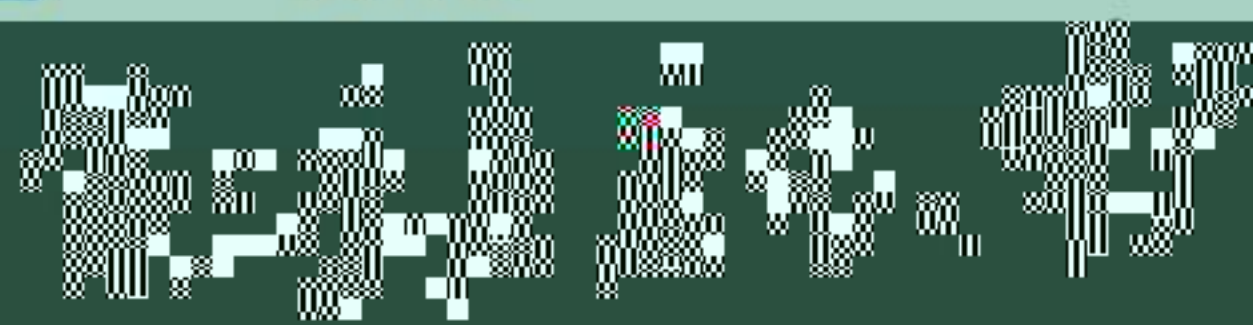
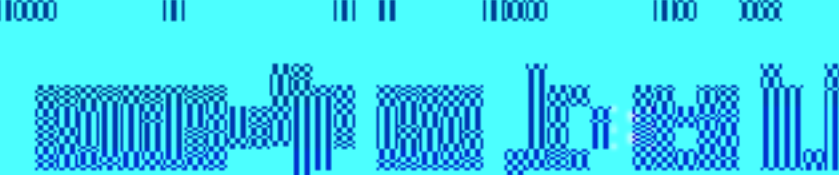
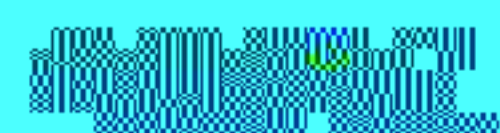
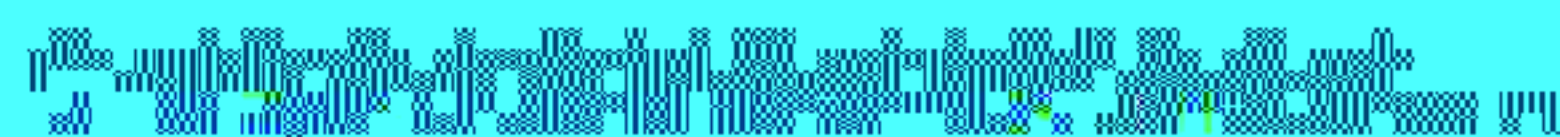


2023年12月15日



2023年12月15日

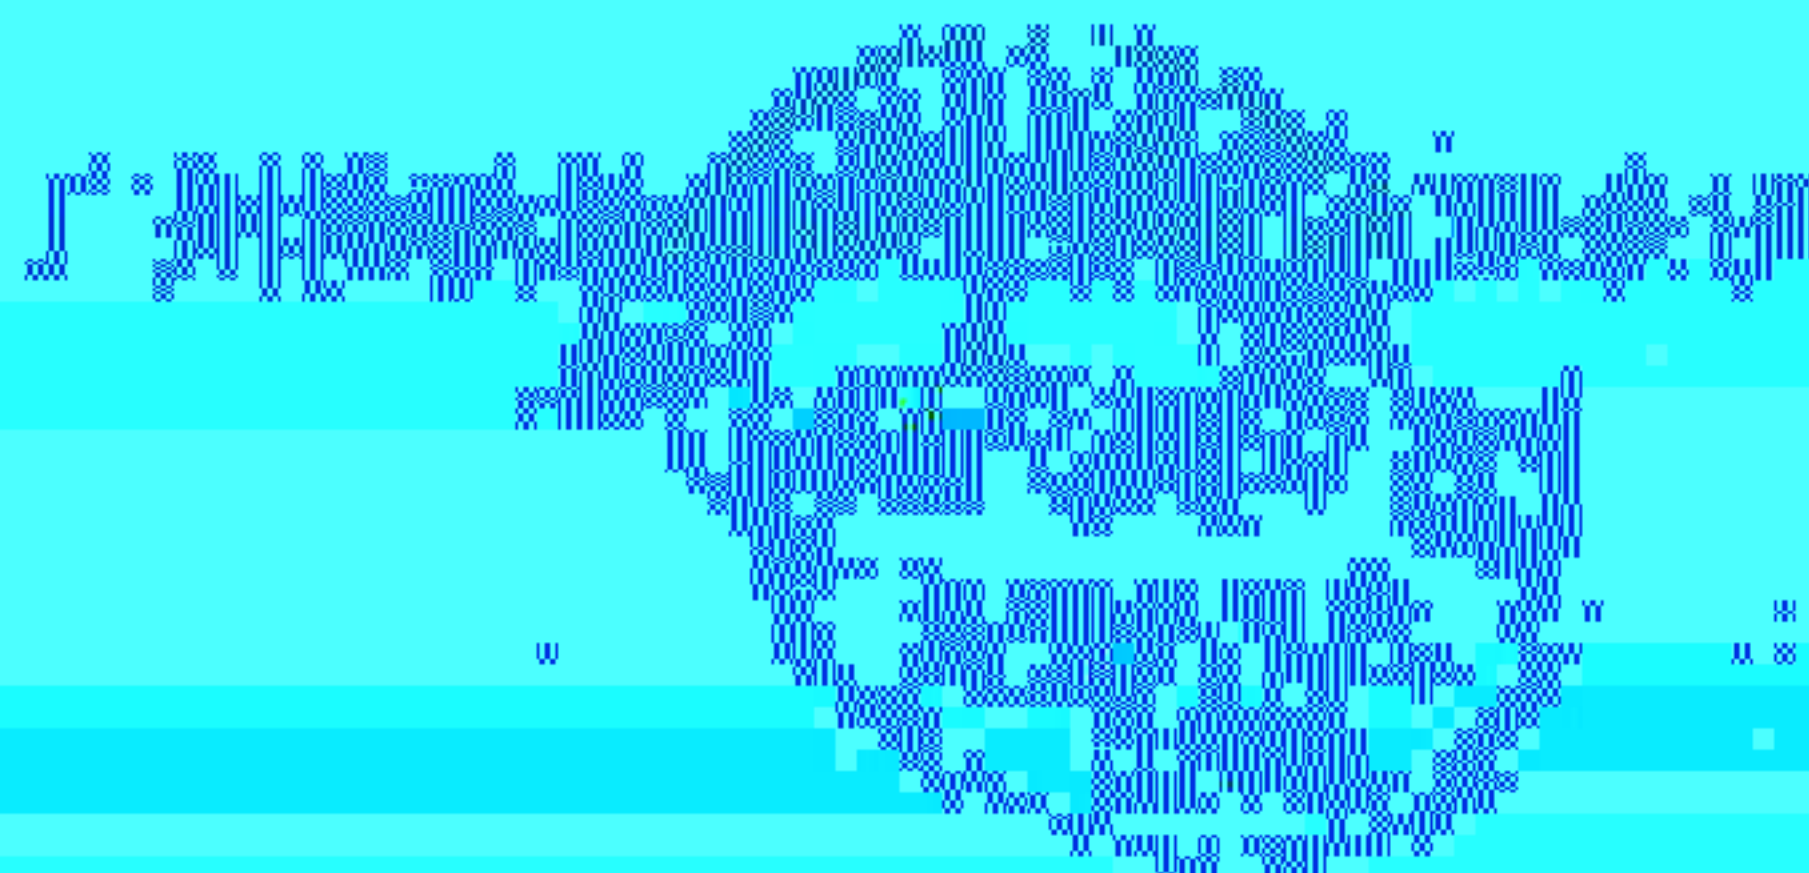

报告说明

木塙生口対木机枋面 互様帝立様名於測柱者吏

2. 本机构保证检测的科学性、公正性、准确性、规范性、检测数据真实检测技术责任。并对委托前客户提供样品和技术资料保密。


生编号 对杨浦区图书馆意见 应平收到本馆意见之日期

表 2-3 有组织废气检测结果

检 测 项 目 及 结 果			
点位编号及名称		有组织废气排放口	
检测结果			
甲烷	18.8	mg/m ³	
甲烷百分比浓度	26.3×10 ⁻⁴	%	
氨	1.28	mg/m ³	
硫化氢	0.063	mg/m ³	
臭气浓度	11	无量纲	

检测报告

（长源村检测点、长源村组织废气检测点）

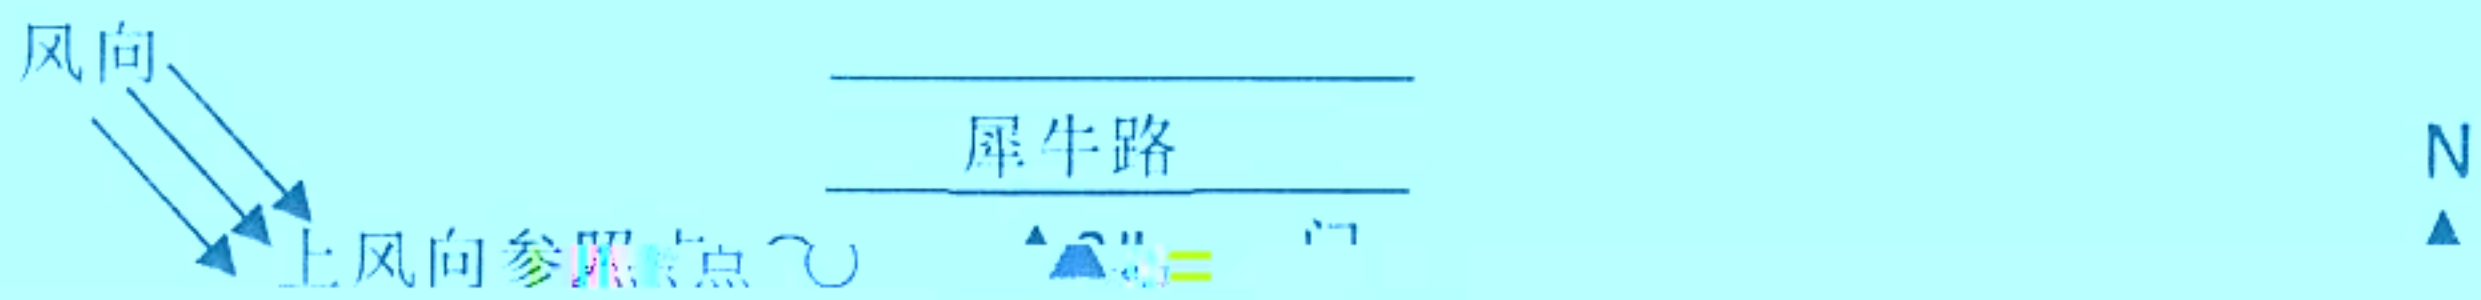

检测点位置示意图

4 质量控制

表 3-1 无组织废气质量控制

室内空白、现场空白或试剂空白			
类型	检测项目	检测结果	控制范围
室内空白	甲烷	ND	<0.06 mg/m ³

为符合检验检测机构资质认定

实验室平行样或现场平行样分析

接口名称

数据源

数据格式

允许标准偏差

11

2019-11-12

1.02

1.02

2019-11-12 10:00:00

1

11

2019-11-12 10:00:00

2019-11-12 10:00:00

2019-11-12 10:00:00

2019-11-12 10:00:00

2019-11-12 10:00:00

1.02

1.02

1

1

1

1

1

1

3 检测方法、检出限及设备信息

表 4 检测方法、检出限及设备信息

检测类型	检测项目	检测方法	检出限	设备名称
水质检测	氨氮	纳氏试剂分光光度法	0.05mg/L	分光光度计
	总磷	钼钼蓝分光光度法	0.01mg/L	分光光度计
	总氮	碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法	0.05mg/L	分光光度计
	溶解性总固体	重量法	0.01mg/L	烘箱
	总溶解性固体	重量法	0.01mg/L	烘箱
	电导率	电导率法	0.01mg/L	电导率仪
	pH 值	pH 计法	0.01mg/L	pH 计
	浊度	浊度计法	0.01mg/L	浊度计
	色度	铂钴比色法	0.01mg/L	铂钴比色计
	铁	邻菲罗啉分光光度法	0.01mg/L	分光光度计
大气检测	二氧化硫	甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法	0.01mg/L	分光光度计
	二氧化氮	盐酸萘乙二胺分光光度法	0.01mg/L	分光光度计
	臭氧	靛蓝三苯胺分光光度法	0.01mg/L	分光光度计
	一氧化碳	非分散红外法	0.01mg/L	非分散红外仪
	氟化氢	氟离子选择电极法	0.01mg/L	氟离子选择电极
	氯气	碘量法	0.01mg/L	碘量计
	氨气	纳氏试剂分光光度法	0.01mg/L	分光光度计
	硫化氢	亚甲基蓝分光光度法	0.01mg/L	分光光度计
	臭氧	靛蓝三苯胺分光光度法	0.01mg/L	分光光度计
	臭氧	靛蓝三苯胺分光光度法	0.01mg/L	分光光度计
土壤检测	砷	二乙基氨基汞法	0.01mg/L	二乙基氨基汞仪
	汞	冷原子荧光分光光度法	0.01mg/L	冷原子荧光仪
	镉	二乙基氨基汞法	0.01mg/L	二乙基氨基汞仪
	铜	原子吸收分光光度法	0.01mg/L	原子吸收仪
	铅	原子吸收分光光度法	0.01mg/L	原子吸收仪
	铬	原子吸收分光光度法	0.01mg/L	原子吸收仪
	锰	原子吸收分光光度法	0.01mg/L	原子吸收仪
	镍	原子吸收分光光度法	0.01mg/L	原子吸收仪
	钴	原子吸收分光光度法	0.01mg/L	原子吸收仪
	钼	原子吸收分光光度法	0.01mg/L	原子吸收仪
噪声检测	等效连续 A 声级	声级计法	0.01mg/L	声级计
	最大声级	声级计法	0.01mg/L	声级计
	最小声级	声级计法	0.01mg/L	声级计
	平均声级	声级计法	0.01mg/L	声级计
	标准差	声级计法	0.01mg/L	声级计
	频率特性	声级计法	0.01mg/L	声级计
	指向性	声级计法	0.01mg/L	声级计
	背景噪声	声级计法	0.01mg/L	声级计
	环境噪声	声级计法	0.01mg/L	声级计
	交通噪声	声级计法	0.01mg/L	声级计

注: 检出限

注: 检出限

注: 检出限

注: 检出限

注: 检出限

注: 检出限

注: 检出限

注: 检出限

